


Odsávací souprava Symphony s prsním nástavcem PersonalFit™ PLUS k opakovanému použití

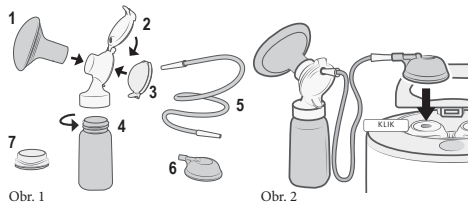

Obr. 1

Obr. 2

Popis produktu

Odsávací souprava Symphony k opakovanému použití je sada příslušenství určená k opakovanému použití s odsávačkou Symphony. Sada obsahuje (viz obr. 1):

- (1) prsní nástavec PersonalFit PLUS
- (2) konektor a uzávěr konektoru
- (3) membránu
- (4) láhev
- (5) hadici
- (6) odsávací kryt Symphony
- (7) víceúčelový uzávěr

Viz pokyny k použití odsávačky a odsávací soupravy Symphony v nemocničním prostředí.

Účel použití

Odsávací souprava Symphony k opakovanému použití je určena k odsávání mateřského mléka pomocí odsávačky Symphony v nemocničním prostředí. Odsávací souprava je produkt pro více uživatelů.

Indikace/kontraindikace

Viz návod k použití odsávačky Symphony v nemocničním prostředí.

Důležité bezpečnostní informace

Význam symbolů:

- Varování
Může způsobit vážný úraz nebo smrt.
- Upozornění
Může způsobit menší poranění.
- Obal obsahuje látky, které mohou přicházet do kontaktu s potravinami dle nařízení 1935/2004.
- Chraňte zařízení před slunečním světlem.
- Dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití.
- Výrobce
- Katalogové číslo
- Datum výroby
- Nesterilní
- Vyhovuje základním požadavkům směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993.


- Varování**
Chcete-li předjet zdravotním rizikům a pro snížení rizika poranění:
I Při použití odsávačky mateřského mléka Symphony v přítomnosti dětí je nutný dohled.
I Před každým použitím zkontrolujte všechny díly odsávací soupravy.
I Nikdy nepoužívejte přístroj, součásti nebo díly, které jsou poškozené.
I Nikdy nepoužívejte přístroj, součásti nebo díly, které jsou špinavé, plesnivě nebo jinak kontaminované.
I Vyměňte plesnivě, poškozené nebo opotřebované díly.
I Z důvodu minimalizace rizika křížové kontaminace nesmí být odsávací souprava používaná více matkami, aniž by byla adekvátním způsobem vyčištěna.
I Používejte pouze originální příslušenství Medela.
I Nepoužívejte příslušenství nedoporučené společností Medela, jinak může dojít k ohrožení bezpečnosti.
I Neupravujte žádné díly odsávačky ani odsávací soupravy.
Důležité!
I Plastové láhve a jednotlivé díly mohou být po zmrazení křehké a mohou se při pádu z výšky rozbít.
I Láhve a jednotlivé díly se mohou poškodit při nesprávném zacházení, například při nárazu, po příliš silném utáhnutí nebo převrnutí.
I S láhvemi i s jednotlivými díly manipulujte opatrně.
I Nepoužívejte mateřské mléko, pokud jsou láhve nebo jednotlivé díly poškozené.
- Upozornění**
Chcete-li předjet riziku kontaminace:
I K čištění použijte výhradně pitnou vodu nebo balenou vodu.
I Neskladujte mokré nebo vlhké díly, protože může dojít ke vzniku plísní.

Čištění a údržba

Uvedené automatické postupy pro přípravu jsou testované, validované a doporučené společností Medela. V případě automatického čištění je zároveň nutné provést interní ověření upřednostňovaného postupu dle pravidel příslušné nemocnice. V případě konfliktu národních požadavků pro čištění a sterilizaci budou tyto převažovat nad doporučeními společnosti Medela.

- Varování**
I Produkt není sterilní. Před prvním použitím vyčistěte všechny díly, které se dostanou do styku s prsem nebo mateřským mlékem.
I Použít více než jednu matku bez náležité opatrné údržby/čištění může představovat riziko a mohlo by způsobit křížovou kontaminaci.
I Díly, které přicházejí do styku s prsem nebo mateřským mlékem vyčistěte ihned po použití.

Odsávací souprava Symphony s prsním nástavcem PersonalFit™ PLUS k opakovanému použití

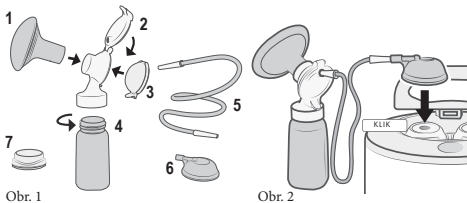

Obr. 1

Obr. 2

Popis produktu

Odsávací souprava Symphony k opakovanému použití je sada příslušenství určená k opakovanému použití s odsávačkou Symphony. Sada obsahuje (viz obr. 1):

- (1) prsní nástavec PersonalFit PLUS
- (2) konektor a uzávěr konektoru
- (3) membránu
- (4) láhev
- (5) hadici
- (6) odsávací kryt Symphony
- (7) víceúčelový uzávěr

Viz pokyny k použití odsávačky a odsávací soupravy Symphony v nemocničním prostředí.

Účel použití

Odsávací souprava Symphony k opakovanému použití je určena k odsávání mateřského mléka pomocí odsávačky Symphony v nemocničním prostředí. Odsávací souprava je produkt pro více uživatelů.

Indikace/kontraindikace

Viz návod k použití odsávačky Symphony v nemocničním prostředí.

Důležité bezpečnostní informace

Význam symbolů:

- Varování
Může způsobit vážný úraz nebo smrt.
- Upozornění
Může způsobit menší poranění.
- Obal obsahuje látky, které mohou přicházet do kontaktu s potravinami dle nařízení 1935/2004.
- Chraňte zařízení před slunečním světlem.
- Dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití.
- Výrobce
- Katalogové číslo
- Datum výroby
- Nesterilní
- Vyhovuje základním požadavkům směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993.


- Varování**
Chcete-li předjet zdravotním rizikům a pro snížení rizika poranění:
I Při použití odsávačky mateřského mléka Symphony v přítomnosti dětí je nutný dohled.
I Před každým použitím zkontrolujte všechny díly odsávací soupravy.
I Nikdy nepoužívejte přístroj, součásti nebo díly, které jsou poškozené.
I Nikdy nepoužívejte přístroj, součásti nebo díly, které jsou špinavé, plesnivě nebo jinak kontaminované.
I Vyměňte plesnivě, poškozené nebo opotřebované díly.
I Z důvodu minimalizace rizika křížové kontaminace nesmí být odsávací souprava používaná více matkami, aniž by byla adekvátním způsobem vyčištěna.
I Používejte pouze originální příslušenství Medela.
I Nepoužívejte příslušenství nedoporučené společností Medela, jinak může dojít k ohrožení bezpečnosti.
I Neupravujte žádné díly odsávačky ani odsávací soupravy.
Důležité!
I Plastové láhve a jednotlivé díly mohou být po zmrazení křehké a mohou se při pádu z výšky rozbít.
I Láhve a jednotlivé díly se mohou poškodit při nesprávném zacházení, například při nárazu, po příliš silném utáhnutí nebo převrnutí.
I S láhvemi i s jednotlivými díly manipulujte opatrně.
I Nepoužívejte mateřské mléko, pokud jsou láhve nebo jednotlivé díly poškozené.
- Upozornění**
Chcete-li předjet riziku kontaminace:
I K čištění použijte výhradně pitnou vodu nebo balenou vodu.
I Neskladujte mokré nebo vlhké díly, protože může dojít ke vzniku plísní.

Čištění a údržba

Uvedené automatické postupy pro přípravu jsou testované, validované a doporučené společností Medela. V případě automatického čištění je zároveň nutné provést interní ověření upřednostňovaného postupu dle pravidel příslušné nemocnice. V případě konfliktu národních požadavků pro čištění a sterilizaci budou tyto převažovat nad doporučeními společnosti Medela.

- Varování**
I Produkt není sterilní. Před prvním použitím vyčistěte všechny díly, které se dostanou do styku s prsem nebo mateřským mlékem.
I Použít více než jednu matku bez náležité opatrné údržby/čištění může představovat riziko a mohlo by způsobit křížovou kontaminaci.
I Díly, které přicházejí do styku s prsem nebo mateřským mlékem vyčistěte ihned po použití.

Odsávací souprava Symphony s prsním nástavcem PersonalFit™ PLUS k opakovanému použití

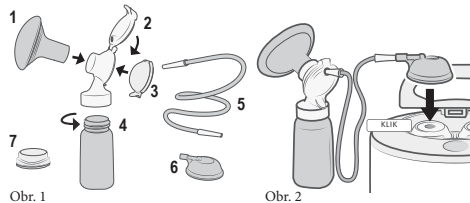

Obr. 1

Obr. 2

Popis produktu

Odsávací souprava Symphony k opakovanému použití je sada příslušenství určená k opakovanému použití s odsávačkou Symphony. Sada obsahuje (viz obr. 1):

- (1) prsní nástavec PersonalFit PLUS
- (2) konektor a uzávěr konektoru
- (3) membránu
- (4) láhev
- (5) hadici
- (6) odsávací kryt Symphony
- (7) víceúčelový uzávěr

Viz pokyny k použití odsávačky a odsávací soupravy Symphony v nemocničním prostředí.

Účel použití

Odsávací souprava Symphony k opakovanému použití je určena k odsávání mateřského mléka pomocí odsávačky Symphony v nemocničním prostředí. Odsávací souprava je produkt pro více uživatelů.

Indikace/kontraindikace

Viz návod k použití odsávačky Symphony v nemocničním prostředí.

Důležité bezpečnostní informace

Význam symbolů:

- Varování
Může způsobit vážný úraz nebo smrt.
- Upozornění
Může způsobit menší poranění.
- Obal obsahuje látky, které mohou přicházet do kontaktu s potravinami dle nařízení 1935/2004.
- Chraňte zařízení před slunečním světlem.
- Dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití.
- Výrobce
- Katalogové číslo
- Datum výroby
- Nesterilní
- Vyhovuje základním požadavkům směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993.

- Varování**
Chcete-li předjet zdravotním rizikům a pro snížení rizika poranění:
I Při použití odsávačky mateřského mléka Symphony v přítomnosti dětí je nutný dohled.
I Před každým použitím zkontrolujte všechny díly odsávací soupravy.
I Nikdy nepoužívejte přístroj, součásti nebo díly, které jsou poškozené.
I Nikdy nepoužívejte přístroj, součásti nebo díly, které jsou špinavé, plesnivě nebo jinak kontaminované.
I Vyměňte plesnivě, poškozené nebo opotřebované díly.
I Z důvodu minimalizace rizika křížové kontaminace nesmí být odsávací souprava používaná více matkami, aniž by byla adekvátním způsobem vyčištěna.
I Používejte pouze originální příslušenství Medela.
I Nepoužívejte příslušenství nedoporučené společností Medela, jinak může dojít k ohrožení bezpečnosti.
I Neupravujte žádné díly odsávačky ani odsávací soupravy.
Důležité!
I Plastové láhve a jednotlivé díly mohou být po zmrazení křehké a mohou se při pádu z výšky rozbít.
I Láhve a jednotlivé díly se mohou poškodit při nesprávném zacházení, například při nárazu, po příliš silném utáhnutí nebo převrnutí.
I S láhvemi i s jednotlivými díly manipulujte opatrně.
I Nepoužívejte mateřské mléko, pokud jsou láhve nebo jednotlivé díly poškozené.
- Upozornění**
Chcete-li předjet riziku kontaminace:
I K čištění použijte výhradně pitnou vodu nebo balenou vodu.
I Neskladujte mokré nebo vlhké díly, protože může dojít ke vzniku plísní.

Čištění a údržba

Uvedené automatické postupy pro přípravu jsou testované, validované a doporučené společností Medela. V případě automatického čištění je zároveň nutné provést interní ověření upřednostňovaného postupu dle pravidel příslušné nemocnice. V případě konfliktu národních požadavků pro čištění a sterilizaci budou tyto převažovat nad doporučeními společnosti Medela.

- Varování**
I Produkt není sterilní. Před prvním použitím vyčistěte všechny díly, které se dostanou do styku s prsem nebo mateřským mlékem.
I Použít více než jednu matku bez náležité opatrné údržby/čištění může představovat riziko a mohlo by způsobit křížovou kontaminaci.
I Díly, které přicházejí do styku s prsem nebo mateřským mlékem vyčistěte ihned po použití.

